

CGM TURBOMED 20.3.2

Service-Pack - Dokumentation



INHALT

1	Allgemeine Informationen zu diesem Service Pack	3
1.1	Ihr CGM TURBOMED-Service-Pack 20.3.2	3
1.2	Installationsnotwendigkeit vor der Abrechnung / dem Quartalswechsel	3
1.3	Neue Prüfmodule	3
1.3.1	Neues Prüfmodul für die KV-Abrechnung	3
1.3.2	Hinweis bei der Abrechnung von Sachkosten in Baden-Württemberg	3
1.4	Durch das Service-Pack erfolgte Aktualisierungen	4
1.5	Installationsvoraussetzungen	4
1.6	Hinweise zur Nomenklatur in diesem Dokument	4
2	Gesetzliche/Vertragliche Neuheiten & Änderungen	5
2.1	Neue Formulare für Corona-Tests	5
2.2	Aktualisierung der EBM-Stammdaten	12
3	Allgemeine Neuheiten & Änderungen	14
3.1	Neue Funktionen des elektronischen Medikationsplans (eMP)	14
4	Anhang	15
4.1	Hilfreiche Präparate-Informationen	15
5	CGM TURBOMED Punkt für Punkt Update-Checkliste zum Service-Pack	16
6	Das Hilfe-System von CGM TURBOMED	18
6.1	CGM TURBOMED Gebrauchsanweisung [F1]	18
6.2	CGM TURBOMED Anwender-Hotline	18

1 Allgemeine Informationen zu diesem Service Pack

1.1 Ihr CGM TURBOMED-Service-Pack 20.3.2

Sehr geehrtes Praxisteam,

heute erhalten Sie das **CGM TURBOMED Service-Pack 20.3.2.4653**.

Mit diesem Service-Pack stellen wir Ihnen unter anderem die gesetzlichen Neuerungen zu einigen Formularen (Muster 10C, Muster OEGD), das aktuelle KBV-Prüfmodul sowie einen aktualisierten EBM-Stamm zum Quartal 3/2020 und einige weitere Erweiterungen und Optimierungen in CGM TURBOMED vor.

1.2 Installationsnotwendigkeit vor der Abrechnung / dem Quartalswechsel

Installieren Sie dieses **CGM TURBOMED Service-Pack 20.3.2 vor der Abrechnung Q3/2020**, wenn Sie in der KV Baden-Württemberg ansässig sind und zu Ihren abgerechneten Sachkosten keine Pseudo-Ziffer angeben müssen/möchten oder wenn Sie EBM-Ziffern verwendet haben, die in der CGM TURBOMED-Version 20.3.1 noch nicht enthalten waren, aber in der u. g. Liste zu finden sind.

1.3 Neue Prüfmodule

1.3.1 Neues Prüfmodul für die KV-Abrechnung

Mit diesem CGM TURBOMED Service-Pack 20.3.2 stellen wir Ihnen das aktuelle **KBV-Prüfmodul 2020.3.3 für Quartal 3/2020** zur Verfügung.

Grund der Aktualisierung: Update der KV-Spezifika-Stammdatei für die KV Baden-Württemberg (52) sowie der bundeseinheitlichen EBM-Stammdatei und der EBM-Stammdateien der KVen Schleswig-Holstein (01), Bremen (03), Westfalen-Lippe (20), Nordrhein (38), Hessen (46), Rheinland-Pfalz (51), Baden-Württemberg (52), Mecklenburg-Vorpommern (78), Brandenburg (83), Sachsen-Anhalt (88) und Thüringen (93).

1.3.2 Hinweis bei der Abrechnung von Sachkosten in Baden-Württemberg

Die von der KBV zum Quartal 3/2020 bereitgestellte und mit dem CGM TURBOMED-Update 20.3.1 an Sie ausgelieferte KV-Spezifika-Stammdatei für die KV Baden-Württemberg enthält eine Vorgabe zur Abrechnungspflicht einer Pseudo-Gebührenordnungsposition bei der Angabe von Sachkosten. Im Zuge dieser Verpflichtungsvorgabe erscheint in der CGM TURBOMED-Version 20.3.1 folgende Meldung:

Meldung
Sachkosten dürfen nur mit einer entsprechenden Pseudoziffer abgerechnet werden.

Mit einer Nachlieferung vom 09.07.2020 hat die KBV diese Vorgabe für die KV Baden-Württemberg revidiert und mit diesem Update stellen wir Ihnen die entsprechend aktualisierten KV-Spezifika zur Verfügung. Somit entfällt mit der Installation des CGM TURBOMED Service-Pack 20.3.2 die o. g. Meldung

und Sie müssen somit keine Pseudo-GNR mehr für die Abrechnung von Sachkosten angeben. Weitere Rückfragen zu diesem Thema richten Sie bitte an Ihre KV.

1.4 Durch das Service-Pack erfolgte Aktualisierungen

Folgende Listen werden mit dem ersten Programmstart nach dem Update aktualisiert:

- Eigene Listen – EBM 2010-Ziffern

1.5 Installationsvoraussetzungen

Dieses Service-Pack benötigt als Voraussetzung die **CGM TURBOMED - Version 20.3.1.4575**.

Bitte prüfen Sie in CGM TURBOMED über das [?] rechts oben im Patientendesktop, welche Version bei Ihnen installiert ist. Sollten Sie CGM TURBOMED über die DVD installiert haben, ist die korrekte Version bereits auf Ihrem System vorhanden. Falls die DVD nicht zur Hand ist, können Sie das Update auch über unsere Homepage service.turbomed.de herunterladen.

Es werden administrative Rechte für die Installation benötigt.

1.6 Hinweise zur Nomenklatur in diesem Dokument

Um einzelne Steuer- oder Anzeigeelemente sowie Eingabetexte in diesem Dokument so zu kennzeichnen, dass Sie sowohl bei der Anzeige auf Ihrem Monitor als auch bei einem Schwarz-Weiß-Ausdruck gut zu identifizieren sind, wird auf eine eindeutige Formatierung des erklärenden Textes zurückgegriffen. Die Texte unterliegen den folgenden Formatierungsregeln:

- **[alle Steuer- oder Anzeigeelemente, Buttons sowie Eingabetexte in fett und in eckigen Klammern]**
- [\[Pfadangaben in einer Dateistruktur sowie Aufrufpfade innerhalb des Programms in blau und in eckigen Klammern\]](#)
- [\[Hyperlinks oder andere Verlinkungen in blau und unterstrichen\]](#)

2 Gesetzliche/Vertragliche Neuheiten & Änderungen

2.1 Neue Formulare für Corona-Tests


Dieses Service-Pack 20.3.2 beinhaltet die am 25.06.2020 von der KBV bereitgestellten, aber **rückwirkend zum 01.06.2020** geltende Formular Muster 10C und erneut aktualisierte Muster OEGD.

Die Muster enthalten einen **(1) DATAMATRIX-** sowie einen **(2) QR-Code**. Durch ein Scannen des QR-Codes mit der Corona-Warn-App soll es den Versicherten möglich sein, das Testergebnis schneller zu erhalten, da Sie dann eine Information in der App erhalten. Ferner können möglichst viele Kontaktpersonen bei einer Infektion mit dem Virus über die Corona-Warn-App informiert werden, sobald sich der Risikostatus der getesteten Person verändert hat:

Krankenkasse bzw. Kostenträger		Auftrag für SARS-CoV-2 Testung		10C
Name, Vorname des Versicherten		>>>>> Muster nicht kopieren! <<<<<<		
geb. am		Auftragsnummer des Labors		Quartal
		Hier bitte sorgfältig Barcode-Etikett einkleben!		<input type="checkbox"/> Q1
Kostenträgerkennung	Versicherten-Nr.			Geschlecht
Betriebsstätten-Nr.	Arzt-Nr.			<input type="checkbox"/>
Datum		Abnahmedatum	Abnahmezeit	<input type="checkbox"/> Ersttestung <input type="checkbox"/> weitere Testung
Eintrag nur bei Weiterüberweisung!		Arzt-Nr. des Endverfassers		
Betriebsstätten-Nr. des Endverfassers				
<input type="checkbox"/> Testung nach Meldung „erhöhtes Risiko“ durch Corona-Warn-App (GOP 32811)		<input type="checkbox"/> Diagnostische Abklärung (GOP 32918)		
Besondere Risikomerkmale einer Weiterüberweisung (wenn zutreffend, bitte ankreuzen)				
<input type="checkbox"/> Betreu/untergebracht in:	<input type="checkbox"/> Medizinischen Einrichtungen (ambulanzärztlich, z.B. Rettungsdienste, Rehaeinrichtungen)	<input type="checkbox"/> Pflege- und anderen Wohneinrichtungen (z.B. Justizvollzugsanstalten, andere Massenunterkünfte)		
<input type="checkbox"/> Tätigkeit in Einrichtung:	<input type="checkbox"/> Gemeinschaftseinrichtungen (z.B. Kitas, Schulen)	<input type="checkbox"/> Sonstigen Einrichtungen (z.B. nicht medizinische Reife- und Vorleseeinrichtungen, ambulante Dienste der Eingliederungshilfe)		
	<input type="checkbox"/> Das Einverständnis des Versicherten zum Übermitteln des Testergebnisses für Zwecke der Corona-Warn-App auf den vom RKI betriebenen Server wurde erteilt. Dem Versicherten wurden Hinweise zum Datenschutz ausgehändigt.			
Daten für das Gesundheitsamt/RKI - Übermittlung gemäß Infektionsschutzgesetz				
Telefonnummer des Versicherten				
Vertragstiteltempel / Unterschift (Name, Arzt)				
3D6D08-3567F3F2-4DCF-43A3-8737-4CD1F87D6FDA Muster 10C (6.2020)				

Name, Vorname des Versicherten		Gemeinsam schnell die INFEKTIONSKETTE UNTERBRECHEN	
		Die App als Beitrag, um die Pandemie weiter einzudämmen	
Tragen Sie aktiv zur Eindämmung der Pandemie bei. Nutzen Sie die Corona-Warn-App.			
Die App zu nutzen ist ganz einfach. Ihre Daten sind dabei sicher und werden nicht weitergegeben.			
1. Laden Sie die App im Apple Store oder Google Play Store. Die App ist kostenlos.			
2. Richten Sie die App ganz einfach ein. Sie werden dabei in der App angeleitet.			
3. Scannen Sie den QR-Code und Sie erhalten eine Benachrichtigung, sobald Ihr Testergebnis vorliegt.			
4. Im Falle eines positiven Testergebnisses können Sie andere App-Nutzer freiwillig warnen.			
<small>Hinweise zum Datenschutz: Sie möchten die Corona-Warn-App („App“) des Robert-Koch-Instituts (RKI) zum Abrufen Ihres Testergebnisses verwenden. Um Ihr Testergebnis über die App abrufen zu können ist es notwendig, dass Ihr Testergebnis von dem Labor an die Server-Systeme der App übermittelt wird. Verkürzt dargestellt erfolgt dies, indem das Labor Ihr Testergebnis, verkürzt mit einem maschinenlesbaren QR-Code, auf einem hierfür bestimmten Server der App-Infrastruktur ablegt. Der QR-Code ist Ihr Pseudonym, weitere Angaben zu Ihrer Person sind für die Anzeige des Testergebnisses in der App nicht erforderlich. Sie erhalten unterstehend eine Kopie des QR-Codes, der durch die Kamerafunktion Ihres Smartphones in die App eingelesen werden kann. Nur hierdurch ist eine Verknüpfung des Testergebnisses mit Ihrer App möglich. Mit Ihrer Einwilligung können Sie dann Ihr Testergebnis mit Hilfe der App abrufen. Ihr Testergebnis wird automatisch nach 21 Tagen auf dem Server gelöscht. Wenn Sie mit der Übermittlung Ihres pseudonymen Testergebnisses mittels des QR-Codes an die App-Infrastruktur zum Zweck des Testabrufs einverstanden sind, bestätigen Sie dies bitte gegenüber Ihrem Arzt. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Bitte beachten Sie jedoch, dass aufgrund der vorhandenen Pseudonymisierung eine Zuordnung zu Ihrer Person nicht erfolgen kann und daher eine Löschung Ihrer Daten erst mit Ablauf der 21-tägigen Speicherfrist automatisiert erfolgt. Einzelheiten hierzu finden Sie zudem in den >>>Datenschutzrichtlinien der Corona-Warn-App des RKI.</small>			
* Wenn Sie jünger als 16 Jahre alt sind, besprechen Sie die Nutzung der App bitte mit Ihren Eltern oder Ihrer sorgeberechtigten Person.			
	Ihre Notizen:		Scannen Sie diesen QR-Code
3D6D08-3567F3F2-4DCF-43A3-8737-4CD1F87D6FDA			

Auftrag für SARS-CoV-2 Testung nach RVO oder regionaler Sondervereinbarung

OEGD 

>>>>>> **Formular nicht kopieren!** <<<<<<<

Name, Vorname des Versicherten geb. am

Postleitzahl Adresse

Identifikation ÖGD

Auftragsnummer des Labors
Hier bitte sorgfältig Barcode-Etikett ankleben!

Abnahmedatum Abnahmezeit

RVO § 4 Nr. 4 a) RVO Auslandsaufenthalt d/m/w
 regionale Sondervereinbarung KV-Sonderziffer
 Erstattung weitere Testung

§ 2 RVO Kontaktperson § 3 RVO Ausbruchsgeschehen § 4 Nr. 1-3 RVO Verhütung der Verbreitung
 § 2 RVO Meldung „erhöhtes Risiko“ durch Corona-Warn-App § 4 Nr. 4 b) RVO Risikogebiet (Inland)

Besondere Risikomerkmale einer Weiterverbreitung (sofern zutreffend, bitte ankreuzen)

<input type="checkbox"/> Betreuung/untergebracht in:	<input type="checkbox"/> Medizinischen Einrichtungen (ambulanzstationär, z.B. Rehakliniken, Rehaberechnungen)	<input type="checkbox"/> Pflege- und anderen Wohneinrichtungen (andere Massenunterkünfte)
<input type="checkbox"/> Tätigkeit in Einrichtung:	<input type="checkbox"/> Gemeinschaftseinrichtungen (z.B. Kitas, Schulen)	<input type="checkbox"/> Sonstigen Einrichtungen (z.B. mobile medizinische Hilfe- und Versorgungseinrichtungen, ambulante Dienste der Eingliederungshilfe)

Das Einverständnis des Getesteten zum Übermitteln des Testergebnisses für Zwecke der Corona-Warn-App auf den vom RKI betriebenen Server wurde erteilt. Dem Getesteten wurden Hinweise zum Datenschutz ausgehändigt.

Daten für das Gesundheitsamt - Übermittlung gemäß Infektionsschutzgesetz
Telefonnummer des Getesteten

Verbindliches Muster
Stempel des Versetzlers nach RVO oder Sondervereinbarung

D41D11-6C770F1F-EA60-4A57-A988-20267A7C0FE3 OEGD 08.2020

Name, Vorname des Getesteten



Gemeinsam schnell die INFEKTIONSKETTE UNTERBRECHEN
Die App als Beitrag, um die Pandemie weiter einzudämmen

Tragen Sie aktiv zur Eindämmung der Pandemie bei. Nutzen Sie die Corona-Warn-App.
Die App zu nutzen ist ganz einfach. Ihre Daten sind dabei sicher und werden nicht weitergegeben.

- Laden Sie die App im Apple Store oder Google Play Store. Die App ist kostenlos.
- Richten Sie die App ganz einfach ein. Sie werden dabei in der App angeleitet.
- Scannen Sie den QR-Code und Sie erhalten eine Benachrichtigung, sobald Ihr Testergebnis vorliegt.
- Im Falle eines positiven Testergebnisses können Sie andere App-Nutzer freiwillig warnen.

Hinweise zum Datenschutz: Sie möchten die Corona-Warn-App (App) des Robert-Koch-Instituts (RKI) zum Abrufen Ihres Testergebnisses verwenden. Um Ihr Testergebnis über die App abrufen zu können ist es notwendig, dass Ihr Testergebnis von dem Labor an die Server-Systeme der App übermittelt wird. Verkürzt dargestellt erfolgt dies, indem das Labor Ihr Testergebnis, verknüpft mit einem maschinenlesbaren QR-Code, auf einem hierfür bestimmten Server der App-Infrastruktur ablegt. Der QR-Code ist Ihr Pseudonym, weitere Angaben zu Ihrer Person sind für die Anzeige des Testergebnisses in der App nicht erforderlich. Sie erhalten untenstehend eine Kopie des QR-Codes, der durch die Kamerafunktion Ihres Smartphones in die App eingelesen werden kann. Nur hierdurch ist eine Verknüpfung des Testergebnisses mit Ihrer App möglich. Mit Ihrer Einwilligung können Sie dann Ihr Testergebnis mit Hilfe der App abrufen. Ihr Testergebnis wird automatisch nach 21 Tagen auf dem Server gelöscht. Wenn Sie mit der Übermittlung Ihres pseudonymen Testergebnisses mittels des QR-Codes an die App-Infrastruktur zum Zweck des Testabrufs einverstanden sind, bestätigen Sie dies bitte gegenüber Ihrem Arzt. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Bitte beachten Sie jedoch, dass aufgrund der vorhandenen Pseudonymisierung eine Zuordnung zu Ihrer Person nicht erfolgen kann und daher eine Löschung Ihrer Daten erst mit Ablauf der 21-tägigen Speicherfrist automatisiert erfolgt. Einzelheiten hierzu finden Sie zudem in den >>>Datenschutzhinweisen<<< der Corona-Warn-App des RKI.

* Wenn Sie jünger als 16 Jahre alt sind, besprechen Sie die Nutzung der App bitte mit Ihren Eltern oder Ihrer sorgeberechtigten Person.

Ihre Notizen:

 **Scannen Sie diesen QR-Code**

D41D11-6C770F1F-EA60-4A57-A988-20267A7C0FE3

Während das **Muster 10C** allen Arztpraxen zur Verfügung steht, ist das **Muster OEGD** ausschließlich für vom Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) beauftragte Praxen vorgesehen. Beide Formulare lassen sich **in zwei Teile gliedern**: Der **obere Formular-Teil**, mit Informationen zur Beauftragung des Tests, geht an das Labor. Den **unteren Formular-Teil** bekommt der Versicherte. Sichtbar ist der untere Teil in CGM TURBOMED nur dann, wenn BFB eingestellt ist. Die Inhalte des DATAMATRIX-Codes auf der ersten sowie des QR-Codes auf der zweiten Seite sind dabei identisch.

HINWEIS:

- Aufgrund der notwendigen Eindeutigkeit des QR-Codes darf das Formular nicht kopiert werden. Im Falle einer Kopie gäbe es den QR-Code mehrfach und das Testergebnis könnte dann nicht eindeutig zugeordnet werden.

Als Vertragsarzt verwenden Sie für die Beauftragung einer SARS-CoV-2-Testung (bei Tests zur diagnostischen Abklärung, zur Beauftragung einer SARS-CoV-2-Testung nach EBM sowie Tests nach einer Meldung "erhöhtes Risiko" durch die Corona-Warn-App, wenn sich die Person direkt an Sie gewendet hat) künftig bitte nur noch **Muster 10C** (statt Muster 10A).

Das **Muster OEGD** ist hingegen eine Veranlassung von Tests, die im Auftrag des "Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD)" nach der neuen Rechtsverordnung des Bundesgesundheitsministeriums vom 09.06.2020 erfolgen. Hiernach darf ausschließlich der ÖGD oder eine vom ÖGD beauftragte Praxis oder andere medizinische Einrichtungen die Testung von asymptomatischen Patienten veranlassen. Des Weiteren können auch Testungen von Personen ohne Krankheitsanzeichen veranlasst werden, die mit positiv getesteten Personen einen mindestens 15-minütigen persönlichen Kontakt hatten oder in demselben Haushalt leben.

Der **Aufruf** in CGM TURBOMED erfolgt, wie von Muster 10A gewohnt, über den Menüpunkt **[Überweisung]**:

Überweisung	AU	Scheine	Fachärzte	Sonstige	Organisation	Kommuni
Ü → Überweisung gezielt						Umschalt+F6
Überweisung blanko						
Überweisung blanko ohne Datum						
Mehrere Überweisungen gezielt						
Ü → Überweisung Labor						Alt+L
Anforderungsschein Labor (Muster 10A)						Strg+F5
Auftrag für SARS-CoV-2 Testung (Muster 10C)						Strg+Umschalt+C
Auftrag für SARS-CoV-2 Testung OEGD (Muster OEGD)						Strg+O

Zusätzlich kann Muster 10C aus dem Patientendesktop, der Karteikarte sowie F2 via **[STRG+Umschalt+C]** aufgerufen werden. Muster OEGD kann hingegen via Shortcut nur aus dem Patientendesktop über **[STRG+O]** aus aufgerufen werden.

Hinweis

Bitte wählen Sie eine Rechtsgrundlage (RVO oder regionale Sondervereinbarung) aus.

OK

Bei der Auswahl von regionalen Sondervereinbarungen sind Sie verpflichtet eine KV-Sonderziffer einzugeben. Nach Bestätigen von [OK] markiert CGM TURBOMED die dafür vorgesehenen Kästchen.

Hinweis

Bitte geben Sie eine KV-Sonderziffer ein oder wählen Sie eine andere Rechtsgrundlage.

OK

Bei RVO ist die Angabe eines Beauftragungsgrundes erforderlich. Auch hier unterstützt CGM TURBOMED und springt in die dafür verpflichtenden Felder.

Hinweis

Bei der von Ihnen ausgewählten Rechtsgrundlage ist die Angabe eines Beauftragungsgrundes notwendig.

OK

Ist eine Voreinstellung bereits vorhanden, bietet CGM TURBOMED eine alternative Einstellung des neuen Musters OEGD an. Betätigen Sie aus dem Formular Muster OEGD heraus [STRG+E], gelangen Sie über [Zusatz] in die Formular-Einstellungen

Allgemein Ausdruck BG Blanko BFB

SARS CoV_2 Testung_OEGD

Übernehmen **Abbrechen**

Zusatz **Karteitext**

Information:
Wählen Sie hier die Ausgabeform der Diagnosen auf dem Formular aus. Diese Einstellungen werden bei einem Kassenbehandlungsfall gültig.

Diagnosenaufruf

Kassenbehandlungsfall	BG Behandlungsfall	Privatbehandlungsfall
ICD10 mit Klartext <input type="checkbox"/>	ICD10 mit Klartext <input type="checkbox"/>	ICD10 mit Klartext <input type="checkbox"/>
Klartext mit ICD10 <input type="checkbox"/>	Klartext mit ICD10 <input type="checkbox"/>	Klartext mit ICD10 <input type="checkbox"/>
ICD10 <input checked="" type="checkbox"/>	ICD10 <input type="checkbox"/>	ICD10 <input type="checkbox"/>
Klartext <input type="checkbox"/>	Klartext <input checked="" type="checkbox"/>	Klartext <input checked="" type="checkbox"/>
Optionale Erläuterung <input checked="" type="checkbox"/>	Optionale Erläuterung <input checked="" type="checkbox"/>	Optionale Erläuterung <input type="checkbox"/>

Ziffern-Vorschläge

von: ▼

EBM ▼

GOÄ96 ▼

UVGOÄ ▼

Automatische Aktualisierung Desktop-Icons

Mit einem Klick auf die [...] oder mit einem Doppelklick auf den Inhalt des Formular-Feldes öffnet sich die Auswahl für die Muster.

SARS-CoV-2 Testung OEGD Zusatzeinstellungen

Rufnummer des Patienten autom. setzen	Telefon	...
Sonst. Hilfen	<input type="checkbox"/>	
Barcodeausdruck aktivieren	<input checked="" type="checkbox"/>	X
Blutabnahmedatum automatisch setzen	<input checked="" type="checkbox"/>	X
Blutabnahmezeit automatisch setzen	<input checked="" type="checkbox"/>	X
Formular	SARS_CoV_2_Testung_OEGD, Version 06.2020 ...	

Übernehmen **Abbrechen**

Wählen Sie die aktuelle Formular-Version mit einfachem Mausklick aus und übernehmen diese, öffnet sich anschließend das aktuelle Muster OEGD.

SARS_CoV_2_Testung_OEGD, Version 06.2020
SARS_CoV_2_Testung_OEGD, Version 08.2020

OK **Abbrechen**

Such.=F9|Ans. Aktual.=F5

Mit einem Klick auf **[Übernehmen]** ist das aktuelle Muster OEGD hinterlegt.

2.2 Aktualisierung der EBM-Stammdaten

Folgende Änderungen an den EBM-Stammdaten werden mit diesem CGM TURBOMED-Update bereitgestellt:

- Änderung der Legende und Aufnahme einer neuen ersten Anmerkung der GOP 32816
- Änderung der Legende der GOP 01450
- Änderung und Aufnahme der abgeleiteten GOP 01952W
- Aufnahme der GOP 01953
- Änderung des obligaten Leistungsinhaltes sowie der ersten Anmerkung der GOP 02402
- Änderung der ersten Anmerkung der GOP 13294, 13344, 13394, 13494, 13543, 13594, 13644 und 13694
- Aufnahme einschließlich der Ableitungen 04567I und 13603I
- Verlängerung der bis zum 30. Juni 2020 befristeten Beschlüsse der 478., 485., 493. und 496. Sitzung des BA (schriftliche Beschlussfassungen) zum Coronavirus SARS-CoV-2 um ein Quartal bis zum 30. September 2020
- Keine Verlängerung der bis zum 30. Juni 2020 befristeten Beschlüsse des BA der 483. und 491. Sitzung (491. Sitzung: GOP 01433 und 01434: Streichung; GOP 14220: Streichung der vierten Anmerkung; GOP 16220: Streichung der vierten Anmerkung; GOP 21220: Streichung der vierten Anmerkung; GOP 22220: Streichung der fünften Anmerkung; GOP 23220: Streichung der vierten Anmerkung; GOP 40122 Streichung)
- Streichung der zweiten Anmerkung der GOP 01952
- Änderung der ersten Anmerkung der GOP 14223
- Änderung der Legende und der Kurzbezeichnung der GOP 12221
- Änderung der dritten Anmerkung der GOP 32811
- Änderung der ersten Anmerkung der GOP 40101
- Änderung der Legende einschließlich Anpassung der Anzahlbedingung der GOP 01450
- Änderung der ersten Anmerkung der GOP 01711 bis 01720 und 01723
- Änderung der dritten Anmerkung der GOP 03335
- Änderung der Leistungslegende und bei der GOP 13652 Streichen der GOP 13650 als Grundleistung
- Änderung der Kurzlegenden der GOP 13545 und 13652
- gesamtes Kapitel 40: sofern noch nicht vorhanden Anpassung von Arztgruppen "mit besonderen Qualifikationsvoraussetzungen" gemäß Beschlussnummer 5
- Aufnahme einschließlich der Ableitungen 04417I und 13577I
- Änderung der Bewertungen der GOP 01741, 01742, 04511, 04514, 04515, 04520, 08311, 08334, 09315, 09317, 13260, 13400, 13401, 13402, 13421, 13422, 13423, 13430, 13662, 26310, 26311 und 30601
- Aufnahme einschließlich abgeleitete GOP 40460B+F+M, 40461B+F+M, 40462B+F+M gemäß Nr. 4 in Beschlussteil B
- Streichung des ersten Spiegelstriches der GOP 04430
- Anpassung der Angabe für Eignung der Prüfzeit der GOP 04567 und 13603
- Aufnahme einer neuen ersten und zweiten Anmerkung sowie Anpassung der Bewertung der GOP 32816
- Aufnahme einer zweiten Anzahlbedingung gemäß der neuen ersten Anmerkung
- Aufnahme einer neuen zweiten Anmerkung der GOP 35150

- Aufnahme einer neuen zweiten Anmerkung der GOP 35152
- Änderung des obligaten bzw. fakultativen Leistungsinhalts der GOP 35401, 35402, 35405, 35411, 35412, 35415, 35421, 35422, 35425, 35503 bis 35509, 35513 bis 35519, 35523 bis 35529, 35533 bis 35539, 35543 bis 35549 und 35553 bis 35559
- Aufnahme einschließlich der Ableitungen 35431B+V+W, 35432B+V+W und 35435B+R+U+V+W+Y+Z
- Aufnahme einschließlich Ableitungen 35703B+H+Z bis 35709B+H+Z und 35713B+H+R+U+X+Y+Z bis 35719B+H+R+U+X+Y+Z
- Änderung der ersten Anmerkung der GOP 35572
- Änderung der Leistungslegenden der GOP 35591 und 35593 bis 35599
- Aufnahme weiterer Fachgruppen der GOP 01645
- Aufnahme der GOP 61050, 61051, 61052, 61060, 61061, 61062, 61063 und 61064
- Änderung der GOP 61043
- Löschen der Zusatzangabe OP-Schlüssel (5035) der GOP 31098 und 36098
- Anpassung der Leistungsgruppe der Pseudo-GOP 88200C
- Anpassung der Liste der Grundleistungen der GOP 01444 und GOP 01450
- Anpassung der Arztgruppenzuordnung der GOP 01510T, 01511T, 01512T, 02100T und 02101T
- Aufnahme von Anzahl- und Altersbedingungen analog der GOP 01741M
- Anpassung der Arztgruppenzuordnung der GOP 04231, 04231D, 04231V, 08535, 08535X, 30708, 30708V
- Anpassung der Bewertung und der Prüfzeit (Faktor 0,9) der GOP 13505I und 13652I
- Anpassung der Arztgruppenzuordnung der GOP 12221, 32811, 40101
- Anpassung Kennzeichen PFG-Ausschluss analog der Ursprungs-GOP 30931
- Anpassung der Anzahlbedingung GOP 32816
- Korrektur der vdx-Konten der GOP 01741N und 01742N
- Änderung der Bezeichnung im Zusammenhang mit der Aufklärung und Beratung sowie Zusammenstellung der Patientenunterlagen gemäß § 6 Abs. 4 der Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses zum Zweitmeinungsverfahren (Zweitmeinungsverfahren bei einer bevorstehenden Amputation beim Diabetischen Fußsyndrom) - noch nicht in Kraft - der GOP 01645D
- Aufnahme im Zusammenhang mit der Aufklärung und Beratung sowie Zusammenstellung der Patientenunterlagen gemäß § 6 Abs. 4 der Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses zum Zweitmeinungsverfahren (reserviert) der GOP 01645E
- Änderung der Bezeichnung (Zweitmeinungsverfahren bei einer bevorstehenden Amputation beim Diabetischen Fußsyndrom) - noch nicht in Kraft - der GOP Pseudo-GOP 88200D
- Aufnahme Zweitmeinungsverfahren (reserviert) der GOP 88200E
- Anpassung des Kategorie-Verwendungstextes (neue Kategorie K5.2) der GOP 35152B
- Aufnahme für die Übersendung einer AU-Bescheinigung an den Patienten bei telefonischer Ausstellung (Sonderregelung Corona) der GOP Pseudo-GOP 88122
- Aktualisierung der regionalen GO-Stammdaten der KVen Schleswig-Holstein, Hamburg, Westfalen-Lippe, Nordrhein, Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen

HINWEIS:

- Bitte beachten Sie, dass eventuell vorhandene KV-spezifische Gebührenordnungspositionen Vorrang vor den bundeseinheitlichen Ziffern haben.



3 Allgemeine Neuheiten & Änderungen


3.1 Neue Funktionen des elektronischen Medikationsplans (eMP)

Bereits mit der letzten CGM TURBOMED-Version 20.3.1 haben wir Ihnen den elektronischen Medikationsplan (eMP) zur Verfügung gestellt. Mit dem eMP haben Sie die Möglichkeit, den eigenen BMP als eMP auf die eGK des Patienten zu schreiben und von der eGK des Patienten zu lesen. Damit wissen Sie immer, welche Medikamente der Patient aktuell einnimmt.

Mit diesem **CGM TURBOMED Service-Pack 20.3.2** stehen Ihnen nun neben den Menüpunkten auch die dazugehörigen Icons in der Symbolleiste zur Verfügung:



Sobald Sie auf das Icon  (eMP lesen) oder das Icon  (eMP schreiben) klicken, erscheint im Anschluss die PIN-Modus-Auswahl:

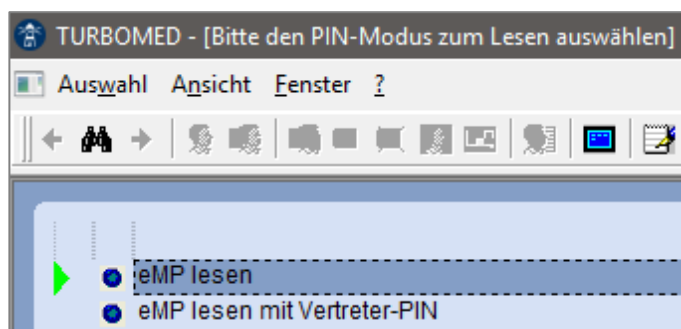

Diese Funktion wurde auch beim Druck des BMP/eMP hinzugefügt. Der Grundeinstellungsschalter [eGK/ eMP automatisch auf die eGK schreiben] sollte hier entsprechend auf [Fragen] oder [Immer] stehen.

Sollten Sie das Lesen des eMPs beim falschen Patienten starten, wird nun der korrekte Patient in CGM TURBOMED aufgerufen. Sollte der Patient mehrere Behandlungsfälle zum gewählten Arzt haben, wird Ihnen zusätzlich die Auswahl der Behandlungsfälle angezeigt. Der eMP wird dann zum ausgewählten Behandlungsfall in der Karteikarte gespeichert.

4 Anhang

4.1 Hilfreiche Präparate-Informationen

Mit diesem Service-Pack stellen wir Ihnen wieder wichtige, patientennahe Präparat-Informationen zur Verfügung. Damit Sie diese umfassend nutzen können, finden Sie im Folgenden Erläuterungen, wie Sie unsere Zusatzfunktionen in Ihrem täglichen Arbeitsablauf unterstützen:

Patienteninformationen: Deutsch, Türkisch, Russisch



Die Patienteninfo ist ein toller Zusatznutzen für Arzt und Patienten!

Nicht nur die Diagnose, auch die gewählte Therapie ist oft erklärungsbedürftig. **Schriftliche Patienteninformationen** stellen sicher, dass die Patienten die gegebenen Informationen zu Hause nochmals in Ruhe nachlesen können. Bei ausgewählten Präparaten erhalten die Ärzte deshalb zum Zeitpunkt der Medikamentenauswahl die Information, dass zu diesem Präparat **Patienteninformationen** verfügbar sind. Da Ärzte international heilen, weisen **Landesflaggen** darauf hin, in welchen Sprachen die Patienteninformationen verfügbar sind. Diese können direkt im Patientengespräch aufgerufen, ausgedruckt und ausgehändigt werden.

Für folgende Präparate haben wir im **Quartal 3/2020 Patienteninformationen** hinterlegt:

Hersteller	Präparat	PZN
Chiesi GmbH	Foster 100/6	00568172 / 06729452
Chiesi GmbH	Foster 200/6	11305435 / 11305441
Chiesi GmbH	Foster Nexthaler 200/6	11305464 / 11305470
Chiesi GmbH	Foster Nexthaler 100/6	09469098 / 09469106
Chiesi GmbH	Trimbow	12777343/ 12777366/ 12777395
Berlin-Chemie	Brimica Genuair	09924119 /09924102 / 10744718 / 10744724

5 CGM TURBOMED Punkt für Punkt Update-Checkliste zum Service-Pack

Installieren Sie das Service-Pack zuerst an Ihrem Server. Wenn bei Ihnen das selbst startende Update über den Server eingerichtet ist, dann müssen Sie das Service-Pack anhand der Checkliste nur am Server installieren. Ihre Arbeitsstationen starten die Installation dann beim ersten Start von CGM TURBOMED eigenständig über das Netzwerk.


Hat Ihr Hardware-Betreuer für Sie eine andere individuelle Update-Routine eingerichtet, so gehen Sie anhand der dafür erstellten Anleitung vor.

CGM TURBOMED Checkliste für das Service-Pack:

- Die CGM TURBOMED-Version 20.3.1.4575 muss installiert sein.
- Starten Sie die Installation nicht während oder kurz vor der Sprechstunde.**
- Führen Sie eine Datensicherung oder Datenspiegelung durch und prüfen Sie diese.**
- Beenden Sie CGM TURBOMED an allen Stationen.
- Beenden Sie Microsoft Word und andere Programme an allen Stationen.
- Starten Sie den Server und die jeweiligen Stationen vor deren Installation neu, um sicherzugehen, dass keine Prozesse den Installationsprozess behindern.**
- Stellen Sie sicher, dass Sie als Administrator angemeldet sind.
- Deaktivieren Sie vorhandene Virens Scanner vorübergehend an allen Stationen.

Installationsprozess:

- Starten Sie das **CGM TURBOMED Service-Pack mit administrativen Rechten**. Um das Service-Pack mit administrativen Rechten zu starten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf **[Service-Pack]** und mit der linken Maustaste auf **[Als Administrator ausführen]**.

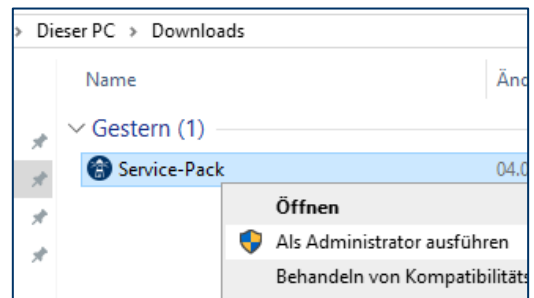


- Folgen Sie den Hinweisen, die Ihnen während des Installationsvorgangs angezeigt werden. Bestätigen Sie alle Updatedialoge mit den Buttons **[Ja]**, **[Weiter]** oder **[Installieren]** soweit angezeigt und schließen Sie die Installation mit **[Fertigstellen]** ab.

Erster Start von CGM TURBOMED nach der Installation des Service-Pack:

- Starten Sie** am Server einmalig Ihr **CGM TURBOMED** manuell **mit administrativen Rechten**. Klicken Sie hierfür mit der rechten Maustaste auf **[CGM TURBOMED]** und mit der linken Maustaste auf **[Als Administrator ausführen]**.

- Bitte lassen Sie das Programm alle ggf. notwendigen Datenbankkonvertierungen durchführen, indem Sie die in diesem Fall erscheinende Abfrage mit dem Button **[Ja]** bestätigen.

WICHTIG: Erst nach dem Abschluss aller notwendigen Datenbankkonvertierungen ist der Installationsprozess vollständig abgeschlossen!

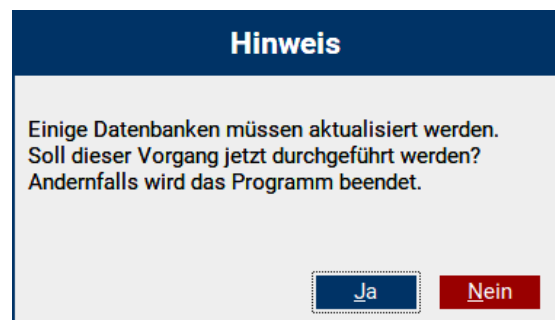

- Starten Sie** nun Ihr **CGM TURBOMED** an allen Arbeitsstationen. Bestätigen Sie die Abfrage zur Installation des Service-Packs.
- Nach der Installation an den Arbeitsstationen muss Ihr **CGM TURBOMED** einmalig **mit administrativen Rechten** gestartet werden. Klicken Sie hierfür mit der rechten Maustaste auf **[CGM TURBOMED]** und mit der linken Maustaste auf **[Als Administrator ausführen]**.
- Direkt nach dem Update **empfehlen wir** einen Neustart des Servers und aller Arbeitsplätze, um alle üblichen Prozesse und Dienste wieder zu starten.

6 Das Hilfe-System von CGM TURBOMED

6.1 CGM TURBOMED Gebrauchsanweisung [F1]

Bei Fragen zur Bedienung von CGM TURBOMED steht Ihnen direkt im Programm eine umfangreiche Gebrauchsanweisung zur Verfügung, die Sie an jeder beliebigen Programmstelle durch Betätigen der Taste [F1] aufrufen können. Diese öffnet sich in demjenigen Kapitel, das dem von Ihnen vor dem Betätigen der Taste [F1] verwendeten CGM TURBOMED-Modul entspricht. Über diesen kontextsensitiven Aufruf der Gebrauchsanweisung hinaus, steht Ihnen selbstverständlich auch eine Suchfunktion zur Verfügung, die Ihnen das Auffinden weiterer Kapitel erleichtert.

6.2 CGM TURBOMED Anwender-Hotline

WIR SIND FÜR SIE DA!

Hotline & Servicezeiten

Telefon: +49 (0) 261 8000-2345*

Fax: +49 (0) 261 8000-3345

Email: hotline.turbomed@cgm.com

oder im Internet unter cgm.com/turbomed

* Montag - Freitag¹ von 08:00 Uhr bis 19:00 Uhr

¹ außer an bundeseinheitlichen Feiertagen

CompuGroup Medical Deutschland AG

Geschäftsbereich TURBOMED

Maria Trost 23, 56070 Koblenz

T +49 (0) 261 8000-2345

F +49 (0) 261 8000-3365

info@turbomed.de

cgm.com/turbomed

cgm.com/de

